

StarLink TV Streamer

Instrukcja obsługi



Akcesorium do
bezprzewodowych
aparatów słuchowych



Wprowadzenie	2
Informacje ogólne	4
Podstawy użycia	6
Łączenie ze źródłami dźwięku	10
Parowanie	11
Uruchomienie/zatrzymanie strumieniowego przesyłania dźwięku	13
Montaż zasilacza	14
Rozwiązywanie problemów	15
Przeznaczenie	17
Informacje FCC	23
Informacje regulacyjne	25

TV streamer został stworzony z myślą o przesyłaniu strumieniowym dźwięku ze źródeł dźwięku do bezprzewodowych aparatów słuchowych 2,4 GHz. Urządzenie telewizyjne może być podłączone do różnych elektronicznych źródeł dźwięku, w tym telewizorów, komputerów, odtwarzaczy MP3, odtwarzaczy DVD i dekodery telewizji kablowej.

Urządzenie telewizyjne może jednocześnie przesyłać strumieniowo dźwięk do nieograniczonej liczby użytkowników, umożliwiając im odsłuch.


Przesyłanie strumieniowe - Przesyłanie dźwięku bezprzewodowo z urządzenia telewizyjnego bezpośrednio do aparatów słuchowych.

Zawartość opakowania


- TV streamer
- Kabel optyczny Toslink
- Przejściówka 3,5mm do RCA
- Instrukcja obsługi

Standardowa konfiguracja

Telewizor Starkey Hearing Technologies

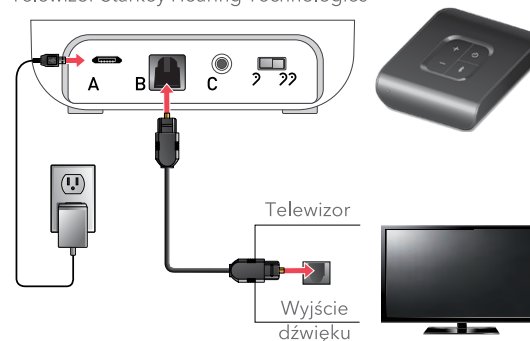

Informacje ogólne

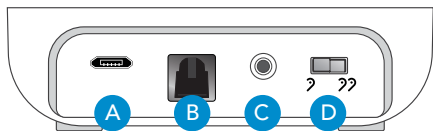

- A. **Gniazdo zasilania:** w zestawie dostarczony jest zasilacz.
- B. **Optyczne gniazdo TOSLINK:** w zestawie dostarczony jest kabel TOSLINK.
- C. **Gniazdo analogowe:** w zestawie dostarczona jest przejściówka 3,5 mm do RCA.
- D. **Przełącznik mono/stereo**

•? (MONO) - wybrać w przypadku korzystania z jednego aparatu słuchowego

•?? (STEREO) - wybrać w przypadku korzystania z dwóch aparatów słuchowych



- ⏻ : Włącza i wyłącza TV streamer
- 🔊 : Parowanie z aparatami słuchowymi
- + i - : Zwiększa głośność strumienia audio, nacisnąć "+". Aby zmniejszyć głośność, nacisnąć "-".

Wskazówka: Głośność strumienia audio można regulować za pomocą aplikacji My Starkey/My Audibel, pilota i/lub elementów sterujących aparatów słuchowych. Więcej informacji na temat konfiguracji Państwa aparatu słuchowego można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od protetyka słuchu.


Diody LED: wskazuje przydatne informacje o urządzeniu telewizyjnym.

Diody LED	STAN OBECNY
Wył.	Zasilanie jest wyłączone
Stały zielony	Zasilanie jest włączone, ale przesyłanie strumieniowe dźwięku nie odbywa się
Stały niebieski	Zasilanie jest włączone i odbywa się przesyłanie strumieniowe dźwięku
Miga na niebiesko	Tryb parowania aparatów słuchowych jest aktywny. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Parowanie na stronie 11.
Stały czerwony	Możliwy błąd


Podstawy użycia

Aby szybko rozpocząć korzystanie z TV streamera ze standardową konfiguracją:


1. Zdjąć plastikowe zatyczki z obu końców kabla TOSLINK.
2. Podłączyć kabel TOSLINK do gniazda Audio OUT elektronicznego źródła audio. Włączyć zasilanie elektronicznego źródła dźwięku.
 - **Uwaga:** W przypadku braku gniazda wyjścia dźwięku TOSLINK należy spróbować innego elektronicznego źródła dźwięku lub spróbować przejściówki 3,5 mm do RCA.
3. Podłączyć drugi koniec kabla TOSLINK z tyłu urządzenia telewizyjnego (gniazdo B).
4. Podłączyć zasilacz do gniazda.
 - **Uwaga:** Jeśli zasilacz nie ma prawidłowej wtyczki, patrz rozdział **Montaż zasilacza** na stronie 14.
5. Wprowadzić wtyczkę micro USB zasilacza do gniazda z tyłu telewizora (gniazdo A).
6. Nacisnąć przycisk zasilania na urządzeniu telewizyjnym, aby go włączyć.




1




2




3



4



5




6


7. Jeśli przednia dioda LED świeci na niebiesko światłem ciągłym, urządzenie telewizyjne wykryło dźwięk i realizuje przetwarzanie strumieniowe.

Wskazówka: Jeśli dioda LED świeci na zielono, należy sprawdzić konfigurację lub zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów.

8. Należy upewnić się, że aparaty słuchowe są włączone.
- **Uwaga:** Przed pierwszą transmisją strumieniową dźwięku niezbędne jest sparowanie aparatów słuchowych z urządzeniem telewizyjnym. Patrz rozdział **Parowanie** na stronie 11.
9. Aby rozpocząć przesyłanie strumieniowe dźwięku,
- otworzyć aplikację My Starkey/My Audibel i wybrać opcję Start Streaming [Rozpocznij strumieniowanie] w urządzeniu telewizyjnym.
 - Patrz **Uruchomienie/zatrzymanie strumieniowego przesyłania dźwięku** na stronie 13, aby poznać dodatkowe opcje.
10. W celu regulacji głośności strumienia, nacisnąć przycisk +/- na urządzeniu telewizyjnym.
11. Aby zatrzymać przesyłanie strumieniowe:
- otworzyć aplikację My Starkey/My Audibel i wybrać opcję Stop Stream [Zatrzymać strumieniowanie] w urządzeniu telewizyjnym.
 - Wyłączyć urządzenie telewizyjne (⏻).
 - Patrz **Uruchomienie/zatrzymanie strumieniowego przesyłania dźwięku** na stronie 13, aby poznać dodatkowe opcje.



7









8



10

Łączenie ze źródłami dźwięku

Dostępne są różne sposoby podłączania źródła dźwięku do TV streamera. Należy dokładnie zapoznać się z elektronicznym źródłem dźwięku, aby określić dostępne opcje dla wyjścia audio (AUDIO OUT).

	Podłączyć kabel do gniazda wyjścia audio (AUDIO OUT) elektronicznego źródła audio.	Podłączyć drugi koniec kabla z tyłu urządzenia telewizyjnego
<p>Optyczny TOSLINK</p> 	 <p>Wyjście Audio</p>	<p>Użyć gniazda B</p> 
<p>Analogowe RCA do 3.5mm</p> 	 <p>Wyjście Audio</p> <p>Uwaga: Podłączyć czerwony do czerwonego i biały do białego</p>	<p>Użyć gniazda C</p> 

Wskazówka: Podczas wstępnej konfiguracji niebieska dioda LED potwierdza, że kabel audio jest prawidłowo podłączony do urządzenia telewizyjnego, a strumieniowe przesyłanie dźwięku jest aktywne.


Parowanie

W celu uzyskania pracy TV streamera z Państwa aparatem (-ami) słuchowym (-i) niezbędne jest uprzednie sparowanie urządzenia telewizyjnego z każdym z nich. Czynność tę wystarczy wykonać raz, ponieważ powinny się one automatycznie rozpoznawać, gdy są włączone i znajdują się w zasięgu sieci bezprzewodowej.*

Aby sparować urządzenie telewizyjne z aparatem(-ami) słuchowym (-i):

1. Należy upewnić się, że aparaty słuchowe nie są podłączone do pobliskich urządzeń Bluetooth. Aby to zrobić,
 - Wyłączyć Bluetooth w telefonie komórkowym.
 - Wyłączyć wszystkie znajdujące się w pobliżu akcesoria dla TV streamera lub Zdalnego mikrofonu +, które wcześniej zostały sparowane z aparatami słuchowymi.
2. Wyłączyć, a następnie włączyć aparaty słuchowe.
3. Umieścić aparaty słuchowe 15 cm od urządzenia telewizyjnego.

*Typowy zasięg działania wynosi do 15 metrów. Zasięg działania może być ograniczony w wyniku czynników środowiskowych, takich jak przeszkody, zakłócenia i położenie ciała ludzkiego. Możliwe są większe odległości, choć jakość dźwięku i łączność mogą ucierpieć.

4. Nacisnąć przycisk  na urządzeniu telewizyjnym. Przednia dioda LED zacznie migać na niebiesko. Przesyłanie strumieniowe dźwięku zostanie tymczasowo zatrzymane podczas tego kroku.
5. W przypadku zestawu aparatów słuchowych:

Pierwsze mignięcie diody LED	Drugie mignięcie diody LED	Wynik parowania	Następny krok
1	2	Oba aparaty słuchowe sparowane	Zakończone
1	2	Tylko jeden aparat słuchowy sparowany	Powtórzyć kroki 1 - 5
1	nie dotyczy	Brak sparowanych aparatów słuchowych	Powtórzyć kroki 1 - 5

6. W przypadku pojedynczego aparatu słuchowego:

Pierwsze mignięcie diody LED	Wynik parowania	Następny krok
1	Sukces	Zakończone
1	Niepowodzenie	Powtórzyć kroki 1 - 4 i 6

Uruchomienie/zatrzymanie strumieniowego przesyłania dźwięku

Strumieniowe przesyłanie dźwięku z poziomu TV streamera można uruchomić (lub zatrzymać) na różne sposoby:

- **My Starkey/My Audibel** - Otworzyć aplikację w telefonie komórkowym lub tablecie. Wybrać opcję uruchomienia/zatrzymania przesyłania strumieniowego.
- **Pilot** - Jeśli został wstępnie skonfigurowany przez protetyka słuchu, należy nacisnąć przycisk Favorite [Ulubione] (☆).
- **Elementy sterujące aparatu słuchowego** - w przypadku wstępnego skonfigurowania przez protetyka słuchu, określone działanie (np. długie naciśnięcie elementu sterowania lub przycisku) może rozpocząć/zatrzymać przesyłanie strumieniowe.

Przesyłanie strumieniowe dźwięku zostanie również zatrzymane w przypadku:


- Niewykrycia sygnału audio na wejściu.
- Wyłączenia urządzenia telewizyjnego.

W aparatach słuchowych może zostać odtworzony sygnał dźwiękowy sygnalizujący rozpoczęcie/zakończenie przesyłania strumieniowego dźwięku.


Montaż zasilacza

TV streamer może występować z różnymi konfiguracjami wtyczek do wykorzystania w różnych krajach. Jeśli zasilacz wymaga montażu:


1. Wybrać odpowiednią wtyczkę stosowaną w Państwa kraju.
2. Wsunąć wtyczkę do zasilacza, aż trafi na miejsce i kliknie.
3. Aby wyjąć wtyczkę, należy nacisnąć zaczep i przesunąć wtyczkę w kierunku przeciwnym do kabla.



1



2



3

Rozwiązywanie problemów

OBJAW	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
Jeden (lub oba) aparaty słuchowe niespodziewanie zaprzestają strumieniowego przesyłania dźwięku.	Aparaty słuchowe mogą znajdować się na granicy zasięgu transmisji bezprzewodowej.	Przysunąć się bliżej do urządzenia telewizyjnego.
	Poziom naładowania baterii w aparacie słuchowym nie pozwala na dalszy odstęp przesyłanego strumieniowo dźwięku.	Wymienić baterię aparatu słuchowego.
	Urządzenie telewizyjne może nie być ustawione w sposób umożliwiający optymalne przesyłanie strumieniowe.	Zmienić orientację urządzenia telewizyjnego, obracając je o kilka stopni w prawo lub w lewo.
	Duży obiekt, na przykład mebel lub ściana, może powodować degradację sygnału.	Najlepsze wyniki uzyskuje się w przypadku, gdy aparaty słuchowe znajdują się w linii wzroku względem urządzenia telewizyjnego.
Dioda LED świeci stale na niebiesko, ale w aparatach słuchowych nie słychać przesyłanego strumieniowo dźwięku.	Aparaty słuchowe nie znajdują się w zasięgu transmisji bezprzewodowej.	Przysunąć się bliżej do urządzenia telewizyjnego.
	Strumień audio musi być uruchomiony ręcznie, by mógł być słyszany w aparatach słuchowych.	Należy uruchomić ręcznie strumień audio za pomocą My Starkey/ My Audibel, pilota lub elementów sterujących aparatu słuchowego.
	Aparaty słuchowe nie są sparowane z urządzeniem telewizyjnym.	Patrz rozdział Parowanie, aby połączyć aparaty słuchowe z urządzeniem telewizyjnym.

OBJAW	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
Powinno odbywać się strumieniowe przesyłanie dźwięku, ale dioda LED świeci stale na zielono.	Kabel audio może być podłączony do wejścia dźwięku „audio IN” w elektronicznym źródle dźwięku.	Należy upewnić się, że kabel jest podłączony do gniazda wyjścia dźwięku „audio OUT” elektronicznego źródła dźwięku.
	Brak dostępnego sygnału audio.	Włączyć elektroniczne źródło dźwięku.
	Dźwięk z elektronicznego źródła audio nie ma prawidłowego formatu.	Ustawić wyjście cyfrowe elektronicznego źródła dźwięku na PCM lub Dolby Audio.
LED świeci ciągłym czerwonym światłem.	Możliwy błąd.	Odcząść zasilacz od gniazda A, odczekać 5 sekund i podłączyć ponownie.
Przesyłany strumieniowo dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem telewizyjnym.	W wielu nowych telewizorach (na przykład telewizorach HD) przetwarzanie sygnału wideo zajmuje dużo czasu, więc mogą opóźnić dźwięk, aby utrzymać synchronizację.	<ul style="list-style-type: none"> Należy spróbować innego gniazda wyjściowego audio (co może wymagać innego rodzaju kabla) w telewizorze. Spróbować innego elektronicznego źródła dźwięku. Na przykład, jeśli obecnie korzystają Państwo z dekodera telewizji kablowej, należy spróbować wyjścia audio w telewizorze lub odwrotnie. Niektóre elektroniczne źródła dźwięku (takie jak telewizory lub amplitunery) oferują wbudowaną opcję regulacji synchronizacji audio i wideo.

Przeznaczenie

TV Streamer to akcesorium do bezprzewodowych aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne. Jest przeznaczony do bezprzewodowego przesyłania dźwięku z telewizora lub innego elektronicznego źródła dźwięku bezpośrednio do aparatu słuchowego na przewodnictwo powietrzne.

Streamer TV został zaprojektowany zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami międzynarodowej kompatybilności elektromagnetycznej. Możliwe jest jednak wystąpienie interferencji spowodowanych zakłóceniami linii energetycznych, lotniskowymi wykrywaczami metali, polami elektromagnetycznymi innych urządzeń medycznych, sygnałami radiowymi i wyładowaniami elektrostatycznymi.

TV Streamer jest przeznaczony do czyszczenia wilgotną ściereczką zwilżoną wodą z mydłem.

Jeśli użytkownik korzysta z innych urządzeń medycznych lub nosi wszczepialne urządzenia medyczne, takie jak defibrylatory lub rozruszniki serca, i obawia się, że urządzenie TV Streamer może powodować zakłócenia pracy urządzenia medycznego, powinien skontaktować się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego w celu uzyskania informacji o ryzyku zakłóceń.

Urządzenie TV Streamer nie powinno być używane podczas rezonansu magnetycznego, w komorze hiperbarycznej ani w innych środowiskach bogatych w tlen.


Urządzenie TV Streamer nie jest formalnie certyfikowane do pracy w atmosferze wybuchowej, jaka może występować w kopalniach węgla lub niektórych fabrykach chemicznych.

Używanie w samolotach

Streamer TV nie powinien być używany na pokładzie samolotu, chyba że personel pokładowy wyrazi na to zgodę.

Użycie międzynarodowe

Streamer TV został zatwierdzony do pracy na częstotliwości radiowej właściwej dla danego kraju lub regionu i może nie być zatwierdzony do użytku poza tym krajem lub regionem. Należy pamiętać, że działanie urządzenia podczas podróży międzynarodowych może powodować zakłócenia innych urządzeń elektronicznych lub innych urządzeń elektronicznych lub inne urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w działaniu urządzenia TV Streamer.



Urządzenie TV powinno być przechowywane i transportowane w zakresie temperatur i wilgotności od -40°C (-40°F) do $+60^{\circ}\text{C}$ (140°F) i wilgotności względnej 10% - 95% oraz limitach wysokości od 70 kPa do 106 kPa (co odpowiada wysokości od 380 m poniżej poziomu morza do 3000 m).

Urządzenie TV jest przeznaczone do pracy w pomieszczeniach w zakresie temperatur od 0°C (32°F) do 40°C (104°F).

Korzyści kliniczne

Samo akcesorium nie zapewnia bezpośrednich korzyści klinicznych. Pośrednią korzyść kliniczną zapewnia umożliwienie urządzeniu nadrzędnemu (beprzewodowym aparatom słuchowym) osiągnięcia zamierzonego celu.

⚠ OSTRZEŻENIE: Należy unikać używania urządzenia TV Streamer bezpośrednio obok innych urządzeń elektronicznych, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. Jeśli takie użycie jest konieczne, należy sprawdzić, czy aparaty słuchowe i inne urządzenia działają normalnie.

⚠ OSTRZEŻENIE: Korzystanie z akcesoriów, podzespołów lub części zamiennych innych niż dostarczone przez producenta TV Streamera może powodować zwiększoną emisję elektromagnetyczną i zmniejszoną odporność elektromagnetyczną, a także może skutkować pogorszeniem wydajności.

⚠ OSTRZEŻENIE: Jeśli przenośny sprzęt komunikacyjny wykorzystujący częstotliwości radiowe jest używany w odległości mniejszej niż 30 cm (12 cali) od urządzenia TV Streamer, może to spowodować pogorszenie działania systemu. W takim przypadku należy odsunąć się od sprzętu komunikacyjnego.

Chociaż TV Streamer nie posiada formalnego certyfikatu (IP) w zakresie ochrony przed wnikaniem pyłu lub wody, zgodnie z normą IEC 60529 został przetestowany pod kątem stopnia ochrony IP 5X. Oznacza to, że TV Streamer jest chroniony przed pyłem.

TV Streamer nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Nie należy go otwierać ani modyfikować.

Nie należy podłączać TV Streamera do żadnych urządzeń, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji.

Przewidywany okres eksploatacji urządzenia TV Streamer wynosi 5 lat.

Opis sieci bezprzewodowej

Starkey Laboratories, Inc. TV Streamer działa w paśmie 2,4-2,4835 GHz z maksymalną efektywną mocą promieniowaną 21 dBm (Ameryka Północna), 10 dBm (reszta świata) z typem modulacji transmisji GFSK i szerokością pasma 2 MHz. Sekcja odbiorcza radiotelefonu ma szerokość pasma 2 MHz.

Streamer TV został przetestowany i przeszedł pomyślnie następujące testy emisji i odporności:

- Wymagania normy IEC 60601-1-2 dotyczące emisji promieniowanych i przewodzonych dla urządzeń klasy B grupy 1, zgodnie z normą CISPR 11.
- Zniekształcenia harmoniczne i wahania napięcia wpływające na źródło zasilania, zgodnie z tabelą 2 normy IEC 60601-1-2.
- Odporność na promieniowanie RF przy poziomie pola 10 V/m w zakresie od 80 MHz do 2,7 GHz, a także wyższe poziomy pola z urządzeń komunikacyjnych, zgodnie z tabelą 9 normy IEC 60601-1-2.
- Odporność na pola magnetyczne o częstotliwości sieciowej przy poziomie pola 30 A/m oraz na zbliżeniowe pola magnetyczne zgodnie z tabelą 11 normy IEC 60601-1-2.
- Odporność na wyładowania ESD na poziomie +/- 8 kV i +/- 15 kV.
- Odporność na szybkie stany nieustalone na wejściu zasilania na poziomie +/- 2 kV przy częstotliwości powtarzania 100 Hz.
- Odporność na przepięcia na wejściu zasilania na poziomie +/- 1 kV linia do linii.

- Odporność na zakłócenia przewodzone indukowane przez pola RF na wejściu zasilania zgodnie z tabelą 6 normy IEC 60601-1-2
- Odporność na spadki i przerwy napięcia na wejściu zasilania zgodnie z tabelą 6 normy IEC 60601-1-2.

ZGŁASZANIE ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH W UE

Wszelkie poważne incydenty związane z urządzeniami należy zgłaszać lokalnemu przedstawicielowi firmy Starkey oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę. Poważny incydent jest definiowany jako jakakolwiek usterka, pogorszenie właściwości i/lub działania urządzenia lub nieprawidłowość w instrukcji obsługi/etykiecie urządzenia, która może prowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia użytkownika LUB może to nastąpić w przypadku ponownego wystąpienia.

Informacje FCC

POWIADOMIENIA DOTYCZĄCE SIECI BEZPRZEWODOWEJ

FCC ID: EOA-24TV

IC: 6903A-24TV (Models 800 and 801)

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC oraz ze standardami RSS zwolnionymi z licencji ISED Canada. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi być odporne na zakłócenia

w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia. FCC i ISED Canada wymagają, aby to urządzenie znajdowało się w odległości co najmniej 20 cm (8 cali) od ciała osoby.

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zakłócenia radiowe lub telewizyjne spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami tego urządzenia. Takie modyfikacje mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Niniejszym Starkey Laboratories, Inc. oświadcza, że Starkey Laboratories, Inc. TV Streamer jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Kopia Deklaracji zgodności można uzyskać pod następującymi adresami oraz na stronie docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Niniejszym firma Starkey Laboratories, Inc. oświadcza, że TV Streamer jest zgodny z brytyjskimi przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych SI 2017 z późniejszymi zmianami. Kopię brytyjskiej deklaracji zgodności można uzyskać pod następującymi adresami oraz na stronie docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Informacje regulacyjne



Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA
www.starkey.com



Starkey Laboratories (Germany) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Germany

Upoważniony Importer na terenie RP:
Starkey Laboratories Poland sp. z o.o.
Ul. Postępu 15
02-676 Warszawa



Ze zużytym sprzętem elektronicznym należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.



Zapoznaj się z instrukcją obsługi





















Przechowywać w suchym miejscu

Instrukcje dotyczące utylizacji starych urządzeń elektronicznych

Firma Starkey Laboratories, Inc. zachęca, UE wymaga, a lokalne przepisy mogą wymagać, aby TV Streamer był utylizowany w ramach lokalnego procesu recyklingu/ unieszkodliwiania elektroniki.

Podczas utylizacji urządzenia TV Streamer należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję obsługi.

Symbol	Symbol Znaczenie	Obowiązujący standard	Numer symbolu
	Producent	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1
	Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Data produkcji	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Numer katalogowy	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Numer seryjny	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Urządzenie medyczne	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Zachowaj suchość	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Limit temperatury	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Ograniczenie wilgotności	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Uwaga	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Ogólny znak ostrzegawczy	EC 60601-1, Nr referencyjny. Tabela D.2, Znak bezpieczeństwa 2	ISO 7010-W001
	Patrz instrukcja obsługi/ broszura	EC 60601-1, Nr referencyjny. Tabela D.2, Znak bezpieczeństwa 10	ISO 7010-M002
	Zbieraj oddzielnie	DYREKTYWA 2012/19/UE (WEEE)	Załącznik IX
	Sprzęt klasy II	IEC 60417 Nr ref. Tabela D1	Symbol 9 (IEC 60417- 5172)
	Znak zgodności z przepisami (RCM)	AS/NZS 4417:2012	NIE DOTYCZY
	Giteki Mark	Japońskie prawo radiowe	NIE DOTYCZY
	Prąd stały	IEC 60601-1 Reference no. Table D1	IEC 60417-5031
	Symbol recyklingu	Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu	Załącznik I-VII



StarLink i Starkey są znakami towarowymi firmy Starkey Laboratories, Inc.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez firmę Starkey jest objęte licencją.

©2023 Starkey Laboratories, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. P00000366 2/23 BKLT3172-01-EN-XX
Patent: www.starkey.com/patents